


Medicinski pripomočki razreda I

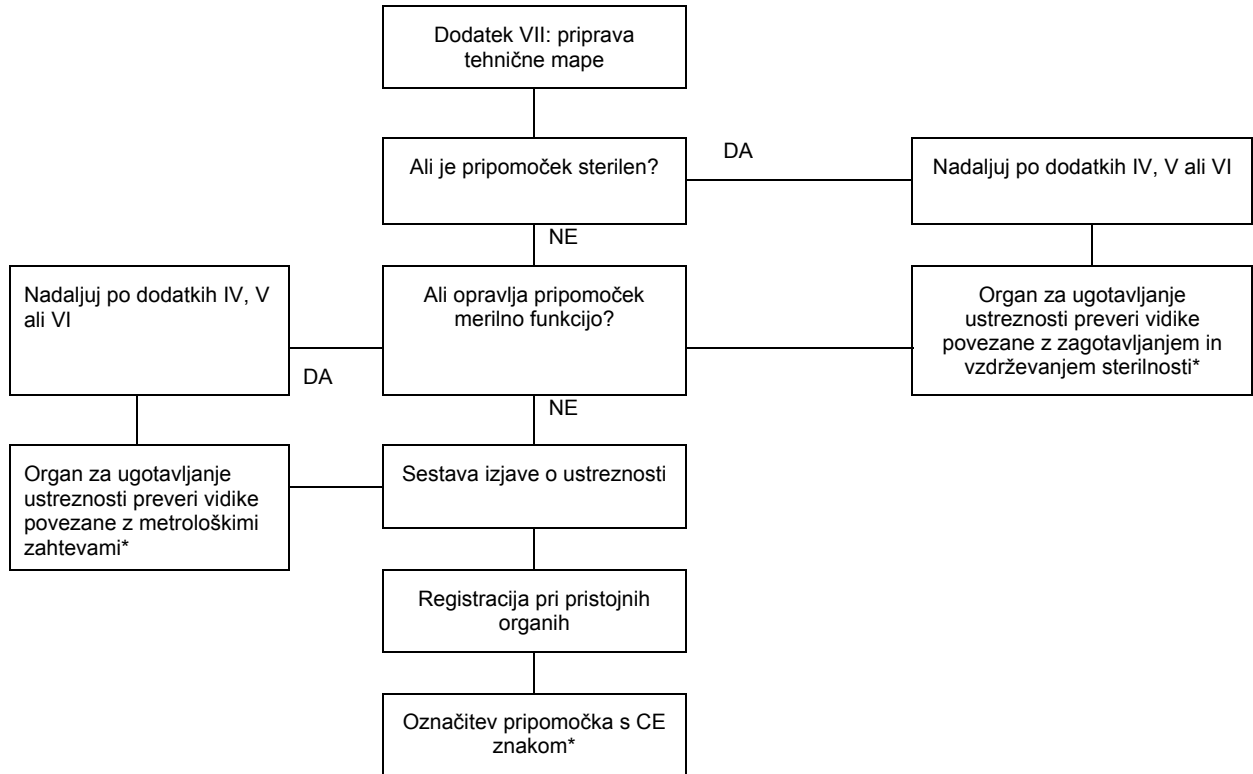

* Če je v postopku sodeloval organ za ugotavljanje ustreznosti, se poleg CE znaka vpiše registracijska številka tega organa